

Pute : Vicair Adjuster O2 (OAD)

Størrelse : _____ Tykkelse: _____


Serie-nr. : _____

Navn på bruker : _____

Navn på behandler : _____

Dato : _____

Fyllingsgrad (antall SmartCells per kammer)*

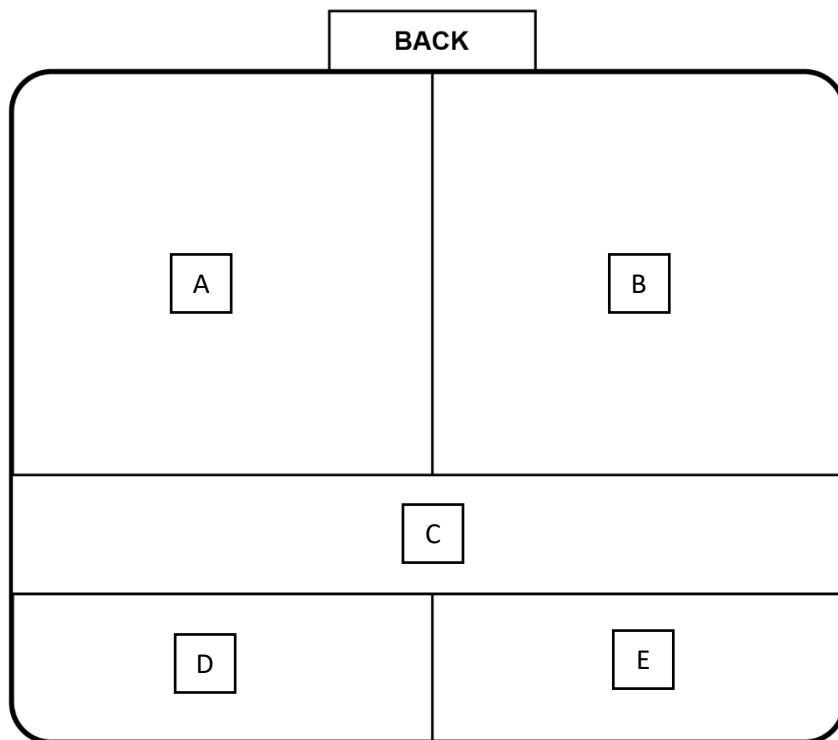

**Merk: Dette skjemaet viser den endrede/justerte fyllingsgraden. Standard fyllingsgrad, altså den opprinnelige fyllingsgraden, finner du på etiketten på selve puten.*

Notater/kommentarer:

Ta godt vare på skjemaet til seinere bruk og referanse

Vicair compartment layout form