

NoDec® BARI Quickguide

NoDec® BARI justerer sig automatisk ind efter patientens vægt og position
 – ingen indstilling skal foretages.

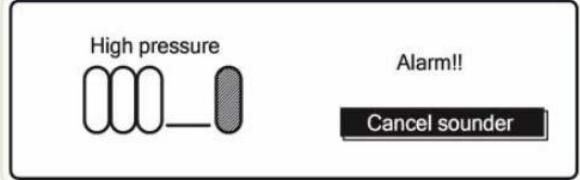
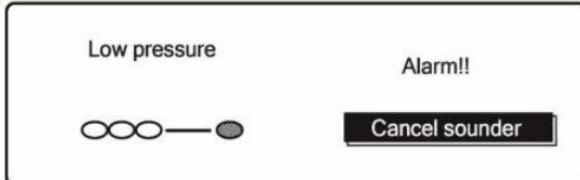
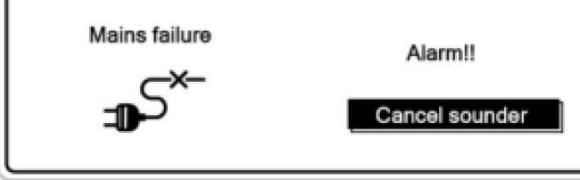
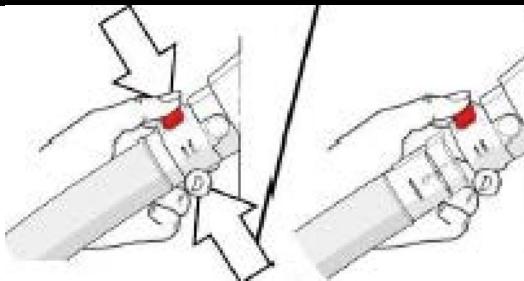
	<ul style="list-style-type: none"> Displayet er låst Tryk og hold ned på displayet indtil låsen er åben Skærmen er låst op og klar til at navigere rundt i Displayet låser automatisk efter 20 sekunder
---	---

Skift (VENSTRE SIDE)	<p>Tryk for ændringer mellem</p> <ul style="list-style-type: none"> Vekseltryk  Statisk  Maks. oppustet (plejefunktion*) – slår automatisk fra efter 20 minutter <p>* Bruges ved forflytning og plejeopgaver</p>
Skift (HØJRE SIDE)	<p>Tryk for ændringer i patientkomfort</p> <ul style="list-style-type: none"> Blød Middel Fast
OK	<p>Tryk for at bekräfte ændringer</p>
Annuler	<p>Vend tilbage til normal drift</p>
Valg	<p>Valgmuligheder</p> <ul style="list-style-type: none"> Lysstyrke på display Lydløs tilstand Sprog

Alarmer/Fejlfinding



ALLE ALARMER VISES MED BLINKENDE RØDT LYS OG LYD

Højt tryk	 
Årsag	Overtryk i madrassen
Løsning	Tryk forsigtigt på CPR-knappen og lad en lille smule luft sive ud. Sluk pumpen og tænd igen.
Lavt tryk	 
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Sæt CPR-ventilen i eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i en celle. Sluk pumpen og tænd igen.
Strømsvigt	 
Årsag	Fejl i strømforsyningen eller pumpen er blevet frakoblet strøm.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sluk pumpen og tænd igen.
NØDSITUATION HJERTESTOP	
Løsning	Grib om slangens end, der går ind i pumpen og tryk på den røde CPR-knap – slangens end springer ud og madrassen tømmes hurtigt for luft.